


Ägglossningstest

Störst chans

Med RFSU Ägglossningstest kan du själv snabbt och enkelt ta reda på när du har ägglossning och störst chans att bli gravid.

Testet spårar ökningen av det Luteiniserande Hormonet (LH) i urinen vid nivåer över 25mIU/ml och visar dina 2 mest fertila dagar. Gör testet mellan kl. 10.00 och 20.00 då mängden LH-hormon i urinen kan avläsas mest korrekt. LH-ökningen äger rum cirka 24–36 timmar innan ett ägg lossnar från äggstocken, s.k. ägglossning. I samband med LH-toppen är du som mest fertil de närmaste 2 dagarna. Har du samlagt de närmaste 48 timmarna ökar dina chanser att bli gravid. Eftersom mäns spermer kan överleva under flera dagar kan du även bli gravid om du har samlagt innan du har påvisat LH-ökningen.

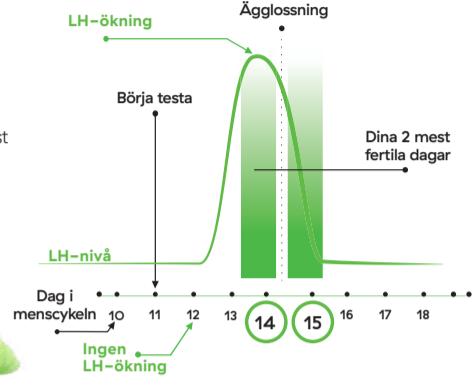

Läs instruktionerna
noggrant!

Frågor och svar

Jag vet inte hur lång min menstruationscykel är eller jag har oregelbunden menses. När ska jag börja testa?
Om du inte känner till hur lång din menstruationscykel är, rekommenderas du att vänta en cykel och räkna ut hur lång den är innan du börjar använda RFSU Ägglossningstest. När du känner till hur lång din menstruationscykel är läser du igenom anvisningarna och tar reda på vilken dag du ska börja testa. Om längden på din menstruationscykel varierar mer än 3 dagar, väljer du den kortaste cykeln du har haft under de senaste 6 månaderna. Det är vanligt att du behöver testa flera gånger innan du kan påvisa LH-stegringen.

Om du vill börja använda RFSU Ägglossningstest innan du tagit på längegen på den menstruationscykeln, kan du börja testa på det 11:e dygnet i cykeln. Det kan dock hända att du missar LH-stegringen eftersom du riskerar att börja testa för sent i cykeln, eller behöver några extra stickor för att kunna påvisa LH-stegringen.

Längden på min menstruationscykel finns inte med i tabellen. När ska jag då börja testa?
Om din cykel är kortare än 21 dagar eller längre än 38 dagar, rådfråga din gynekolog eller läkare.

Vilken tid på dagen ska jag utföra testet?

Du bör utföra testet mellan 10.00 och 20.00 då mängden LH-hormon i urinen kan avläsas mest korrekt, hitta den egen bästa tidpunkt för testning under dagen. Testa ungefärligen samma tid varje dag. Undvik att dricka stora mängder vätiska 2 timmar innan du utför testet för att undvika utspädning av LH-hormonet i urinen.

Måste jag använda alla teststickor?

Nej. Fortsätt testa tills du har påvisat LH-ökningen. Resterande teststickor kan du spara till nästa menstruationscykel, om du vill testa igen.

Hur pålitligt är RFSU Ägglossningstest?

RFSU Ägglossningstest är 99% säkert när det gäller att påvisa den LH-stegring som sker vid ägglossningen. Testet är av samma typ som används av barnmorskor och gynekologer.

Jag har använt många olika teststickor enligt anvisningar, men har inte lyckats påvisa någon LH-ökning. Vad gör jag?

Antalet teststickor i en förpackning brukar i regel vara tillräckligt för de flesta kvinnor med regelbunden menstruation. Men om din menstruationscykel varierar mer än 3 dagar kan det häända att du behöver utföra ytterligare tester för att påvisa din LH-stegring. Fortsätt att testa med stickor från en ny förpackning för att påvisa din LH-stegring.

Viktigt att tänka på

- Läs användaranvisningen noga före användande. RFSU Ägglossningstest är endast ämnad för mätning av LH-hormon i urin enligt instruktionsanvisning. Om instruktionen inte följs i detalj, kan utfallet bli felaktigt.
- Testet är endast för utvärtens bruk och varje teststift är avsedd för engångsbruk.
- Använd inte testet efter utgångsdatum eller om folieomslaget verkar skadat (utgångsdatum finner du på ytter- och innerförpackning).
- Testresultaten påverkas i regel inte av smärtstillande medel, antibiotika och andra vanliga läkemedel. P-piller och p-pläster som innehåller hCG eller LH kan påverka testresultatet och bör inte användas i samband med detta test. Andra faktorer som kan påverka resultaten är om du tar fertilitetsfrämjande läkemedel som innehåller LH- eller hCG-hormon. Hör med din läkare. Om du exempelvis är gravid, nyligen varit gravid eller har uppnått klimakteriet kan resultaten bli missvisande.
- Eftersom RFSU Ägglossningstest ger besked om när jag kan bli gravid, kan jag då använda det som preventivmedel?**
Nej. RFSU Ägglossningstest påvisar den LH-stegring, som inträffar från några timmar upp till ett dygn före ägglossningen. Eftersom mäns spermer kan överleva under flera dagar kan du fortfarande bli gravid om du har samlagt innan du har påvisat LH-stegringen.
- Vad ska jag göra om jag misstänker att jag är gravid?**
Du kan använda RFSU Graviditetstest redan första dagen du skulle ha haft din menstruation. RFSU Graviditetstest är enkelt att använda och du får ett tillförlitligt svar efter 5 minuter. Om testet visar positivt resultat (du är gravid) bör du kontakta din barnmorska eller gynekolog för rådgivning. Ju förr du talar med din barnmorska eller gynekolog, desto bättre är det för din hälsa.
- Kvinnor som lider av polycystiskt äggstocksyndrom (PCOS) kan ha förhöjd LH-koncentration**
- Förvaring**
Förvara testet i obrutna förpackningar i kylskåp eller rumstemperatur. Testet skall inte utsättas för temperaturer under +2°C eller över +30°C. Undvik att utsätta förpackningen för direkt solljus, fukt och värme. Förvaras oätkomligt för barn.
- RFSU är en ideell organisation utan privata vinstdrivna intressen. Överskottet går till information och utbildning i sex- och samlevnadsfrågor, både i Norden och internationellt.
- Vill du veta mer om graviditet och fertilitet eller har frågor om våra produkter, läs mer här**
www.gravidjaellernej.se

• Kvinnor som lider av polycystiskt äggstocksyndrom (PCOS) kan ha förhöjd LH-koncentration

Förvaring
Förvara testet i obrutna förpackningar i kylskåp eller rumstemperatur. Testet skall inte utsättas för temperaturer under +2°C eller över +30°C. Undvik att utsätta förpackningen för direkt solljus, fukt och värme. Förvaras oätkomligt för barn.

RFSU är en ideell organisation utan privata vinstdrivna intressen. Överskottet går till information och utbildning i sex- och samlevnadsfrågor, både i Norden och internationellt.

Vill du veta mer om graviditet och fertilitet eller har frågor om våra produkter, läs mer här
www.gravidjaellernej.se



Använd inte testet om folieförpackningen är skadad.



v2019-11-05-08 art nr I3601SF

RFS-231-06



När ska du börja testa?

Dagen när LH-ökningen inträffar varierar mellan olika kvinnor och från en menstruationscykel till en annan. För att maximera chanserna att detektera din LH-ökning måste du känna till din vanliga cykellängd. Dagen då din mens börjar är dag 1 och cykellängden är totala antalet dagar från dag 1 fram till och med dagen innan din nästa menstruationsblödning börjar.

Om du inte känner till din vanliga cykellängd eller om du har oregelbunden mens där cykellängden varierar, kan du börja testa på dag 11 efter din första mens eftersom menstruationscykels längd i genomsnitt är 28 dagar. Det kan dock hända att du missar din LH-ökning på grund av att du började testa för sent eller behöva testa en längre period. Om din cykellängd varierar med mer än 3 dagar ska du använda den kortaste cykeln.


Använd tabellen för att beräkna vilken dag du ska börja testa.

Menstruationscykels längd	Börja testa
21 dagar	Dag 6
22 dagar	Dag 6
23 dagar	Dag 7
24 dagar	Dag 7
25 dagar	Dag 8
26 dagar	Dag 9
27 dagar	Dag 10
28 dagar	Dag 11
29 dagar	Dag 12
30 dagar	Dag 13
31 dagar	Dag 14
32 dagar	Dag 15
33 dagar	Dag 16
34 dagar	Dag 17
35 dagar	Dag 18
36 dagar	Dag 19
37 dagar	Dag 20
38 dagar	Dag 21

Tiden från ägglossning till mens kan variera men brukar vara 14 dagar. Men eftersom menscykels längd varierar kan tiden från menstruationscykels början till ägglossning skilja sig ganska mycket åt. Exempelvis om man har en regelbunden menstruationscykel på 28 dagar, sker ägglossningen omkring dag 14 räknat från första mensesdagen.

Så här gör du testet

Du bör helst utföra testet vid ungefärlig samma tid alla dagar. Använd inte den första morgenurinen då LH-halten inte påvisas i urinen förrän senare under dagen. Lämpligast tid är mellan kl. 10.00–20.00 då mängden LH-hormon i urinen kan avläsas mest korrekt. Undvik att dricka stora mängder vätiska 2 timmar innan du utför testet för att undvika utspädning av LH-hormonet i urinen. **När du har läst instruktionerna och är redo att utföra testet tar du ut ägglossningstestet ur innerförpackningen. Använd teststickan med en gång. Håll i det gröna handtaget, RÖR INTE den vita ytan då det kan ge felaktiga resultat.**

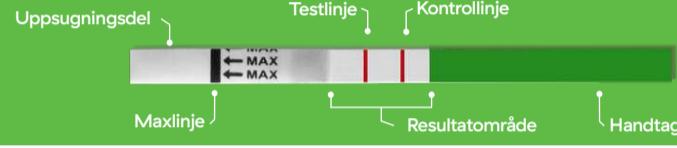

Steg 1. Utför testet

a Samla urin i en ren och torr behållare. Ett par centimeter från botten räcker.

b Håll i det gröna handtaget, RÖR INTE den vita ytan då det kan ge felaktiga resultat.

c Doppa ner uppsugningsdelen med nedåtriktade pilar i urinen. Doppa inte djupare än till max-linjen. Ta upp efter 15 sekunder och lägg den plant på en ren och torr yta.




Steg 2. Vänta 10 min

Vänta i 10 minuter innan du läser av resultaten och låt teststickan ligga helt still. När teststickan börjar reagera färgas hela resultatområdet ljusrosa. Läs inte av några resultaten efter 10 minuter då detta kan ge missvisande resultaten.



Steg 3. Läs av resultatet

Ett eller två rosa färgband visas mot ljus bakgrund i resultatområdet, den ena linjen för kontroll och andra linjen för testresultat. **Läs av resultatet så snart som möjligt efter 10 minuter, läs inte av några resultat efter 15 minuter då detta kan ge missvisande resultat.**

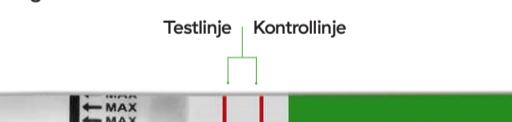

Positivt – LH-ökning


Om två rosa färgade linjer framträder inom resultatområdet och testlinjens rosa färg är lika stark eller mörkare än kontrolllinjen har LH-ökning registrerats. Du bör få ägglossning inom 24–36 timmar. Du är som mest fruktansvärt under de närmaste 2 dagarna. Om du har samlagt under de närmaste 48 timmarna ökar dina möjligheter att bli gravid. Du kan spara överblivna tester om du behöver testa igen.



Negativt – Ingen LH-ökning


Om endast en rosa färgad kontrolllinje framträder men är ljusare än kontrolllinjen så finns ingen påvisad LH-stegring i urinen. Fortsätt testa kommande dagar. Om du inte kunde spåra någon LH-stegring i denna cykel kan det bero på följande:

- Du kanske inte hade någon LH-topp i denna cykel. Det är normalt att ägglossningen hoppar över någon gång.
- Du kan ha testat för tidigt eller för sent i cykeln.
- Mängden LH i urinen kan ha varit för låg.



Ogiltigt resultat

Om inget rosa/rött kontrollstreck är synligt, inga streck alls visas eller om strecken har annan färg än rosa/röda/lila har testet inte fungerat som det ska. Det kan bero på att uppsugningsdelen inte har sugit upp tillräckligt mycket urin eller att du inte har utfört testet på rätt sätt. Gör ett nytt test och följ noga anvisningarna. Om problemet kvarstår kontakta RFSU.



Ovulaatiotesti Parhaat päivät

RFSU Ovulaatiotestillä voit selvittää nopeasti ja helposti, milloin munasolu irtooja ja mahdollisuus tulla raskaaksi on suurimmillaan.

Testi havaitsee lutenisoivan hormonin (LH) pitoisuuden nousun virtsassa kun pitoisuus ylittää 25mIU/ml ja osoittaa 2 päivää, jolloin munasolu hedelmöitymiskyky on parhaimmillaan. Tee testi klo 10.00 – 20.00 välisenä aikana, jolloin LH-hormonin määrä virtsassa on havaittavissa tarkimmin. Lutenisoivan hormonin määrän lisääntyminen tapahtuu noin 24–36 tuntia ennen munasolun irtoamista. Munasoluun hedelmöitymiskyky on paras samana päivänä, kun LH-pitoisuuden nousu havaitaan, ja sitä seuraavana päivänä. Raskauden mahdollisuus kasvaa, jos yhdynä tapahtuu näiden 48 tunnin sisällä. Ohjeiden mukaisesti tehdyn testin varmuus on 99%.



Lue ohjeet huolellisesti

Kysymyksiä ja vastauksia

En tiedä kuukautiskiertona pituutta tai kuukauseni ovat epäsäännölliset. Milloin testauksen voi aloittaa?
Jos et tiedä kuukautiskiertona pituutta, suosittelemme sinun odottavan yhden kierron ajan ja laskavan sen pituuden, ennen kuin aloitat RFSU Ovulaatiotestien käytön. Kun tiedät kuukautiskierron pituuden, lue käyttöohjeet ja selvitä testauksen paras ajoitusajankohta. Jos kuukautiskierron pituus vaihtelee enemmän kuin 3 päivää, valitse kuitenkin edellisen kierrosta kierrosta lyhin. LH:n nousun havaitseminen voi vaatia useampia testauskertoja.

Jos haluat aloittaa RFSU Ovulaatiotestin käytön tietämättä kuukautiskierron pituutta, aloita testaamisen kierron 11. päivänä. LH-tason nousu saattaa kuitenkin jäädä havaitsematta, koska testaus käynnistyy liian myöhään kierrossa. LH-tason nousun havaitseminen voi myös vaatia ylimääräisiä testilisukoja.

Kuukautiskiertona pituutta ei näy taulukossa. Milloin testauksen voi aloittaa?
Jos kuukautiskiertona on alle 21 päivää tai yli 38 päivää, kysy neuvoa gynekologilta.

Mihin aikaan päivästä testi tulee tehdä?
Testi tulisi tehdä klo 10.00 – 20.00 välisenä aikana, jolloin LH-hormonin määrä virtsassa on havaittavissa tarkimmin; valitse itsellesi tällä aikavälillä paras hetki testin tekemiseen. Tee testi samaan aikaan joka päivä. Vältä juomasta suuria määrää nestettä 2 tuntia ennen testin tekemistä, jotta LH-hormonin pitoisuus ei laimene virtsassa.

Onko kaikki testilisukat käytettävä?
Ei. Jatka testausta, kunnes LH-pitoisuuden nousu havaitaan. Loput testilisukat voidaan säästää seuraavalle kuukautiskierolle, jos haluaa testata silloin uudestaan.

Miten luotettava RFSU Ovulaatiotesti on?
RFSU Ovulaatiotesti on 99% varma munasolun irtoamisen yhteydessä tapahtuvan LH-pitoisuuden nousun toteamiseksi. Testi on neuvalan ja gynekologien käyttämän testin kaltainen.


Olen käyttänyt monia eri testilisukoja ohjeiden mukaisesti, mutten ole onnistunut havaitsemaan LH-pitoisuuden nousua. Mitä tehdä?
Pakkauksessa olevien testilisujen määrää riittää useimmissa, joilla on säännölliset kuukausit. Jos kuukautiskierrosta vahitellen enemmän kuin 3 päivää, saatat joutua tekemään useampia testejä havaitaksesi, mikäli virtsan LH-taso nousee. Jatka testaamista uusilla testilisukoilla LH-pitoisuuden nousun havaitsemiseksi.

Hyvä muistaa

- Lue käyttöohjeet huolellisen testauksen aloittamista. RFSU Ovulaatiotesti on tarkoitettu vain virtsan LH-hormonin mittaukseen käyttööhejien mukaiseksi. Jos ohjeita ei noudata yksityiskohtaisesti, tulos voi olla virheellinen.
- Testi on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön, ja testilisukka on kertakäytöinen.
- Älä käytä testiä (ulko- ja sisäpakkauksessa mainitun) viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Säryläkkeet, antibiootit ja muut tavalliset lääkkeet eivät yleensä vaikuta testin tuloksiin. hCG- tai LH-hormonia sisältävät e-pillerit ja ehkäisylastari saattavat kuitenkin vaikuttaa tulokseen, eikä niitä tule käytettää testin yhteydessä. Testi ei toimi raskauden tai lääkäriä. Tuloksesta voi tulla harhaanjohtava raskauden tai vähdevuosien johdosta.
- Jos olet epävarma tuloksesta tai se ei vastaa odotustasi, ota yhteyttä gynekologiin, neuvalaan tai lääkärin.
- Kierrätä! Lajittele pakkauksen paperikeräykseen ja käytetty liuskas sekä jätteeseen.
- Testi on säälytettävä huoneenlämmössä ennen käyttöä.
- Käytä aina tuoretta virtsanäytettä testin tekemiseen.

Mitä ovulaation yhteydessä tapahtuu?

Lutenisoivan hormonin (LH) erityis lisääntyy yleensä voimakkaasti ennen munasolun irtoamista, suunnilleen kuukautiskierron puolivälistä (ns. munasoluun irtoaminen) muuttamasta tunnista yhteen vuorokauseen ulottuvan ajan kuluessa tästä huipusta. LH-huipun yhteydessä munasolu on hedelmöitymiskykyis seuraavan kahden vuorokauden ajan. Raskauden todennäköisyys kasvaa, jos yhdynä tapahtuu näiden 48 tunnin kuluessa. Koska miehen siittiöt voivat elää useiden päivien ajan, raskaaksi voi tulla, vaikka yhdynä olisi tapahtunut ennen LH-huippua.

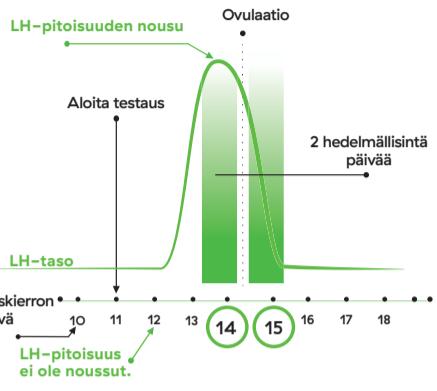

Esimerkkinä käytetty 28 päivän kuukautiskierroa. Ovulaation ajankohta voi vaihdella kuukautiskierrosta toiseen.

Milloin testauksen voi aloittaa?

LH-pitoisuuden nousun ajankohdan vaihtelut ovat yksilöllistä ja se vaihtelee myös kuukautiskierrosta toiseen. Oman kuukautiskierron pituuden tunteminen maksimoi mahdollisuuden havaita LH-pitoisuuden nousu. Kuukautisten alkamispäivä on kierron 1. päivä, ja kierron pituus lasketaan tästä päivästä seuraavien kuukautisten alkamista edeltävään päivään.


Jos kuukautiskierron pituutta ei tiedetä tai jos kuukausit ovat epäsäännölliset ja kierron pituus vaihtelee, voi testauksen käynnistää 11 päivää kuukausien ensimmäisenä päivänä jälkeen, koska kuukautiskierron pituus on keskimäärin 28 päivää. Voi kuitenkin tapahtua, ettei LH-pitoisuuden nousua havaita, koska testaus käynnistettiin liian myöhään tai testausta on suoritettava pidemmän kauden aikana. Jos kuukautiskierron pituus vaihtelee enemmän kuin 3 päivää, aloita testaus lyhyimmän kierron mukaan.

Taulukon avulla voit laskea, milloin testaus kannattaa aloittaa.
Ensimmäinen vuotopäivä on päivä 1. Jos kuukautiskierrosta on alle 21 päivää tai yli 38 päivää, kysy neuvoa gynekologilta. Kaikilla naisilla munasolu ei irtota kuukautiskierroista puolivälistä, minä takia positiivista tulosta ei ehkä saada testin ensimmäisten viiden päivänä. Tee testi päivittäin 7 päivänä jälkeen, tai kunes LH-pitoisuuden nousu havaitaan.

Seuraavien kuukausien alkamisaikojen munasoluun irtoaminen jälkeen voi vaihdella, mutta vähissä on yleensä 14 päivää. Koska kuukautiskierron pituus vaihtelee, voi alkaa kuukausien ensimmäisestä päivästä munasoluun irtoamiseen vaihdella. **Jos kuukautiskierrosta on esim. 28 päivää, munasoluun irtoaminen tapahtuu noin 14 päivää ensimmäisen vuotopäivän jälkeen.**


Näin teet testin

Tee testi jokaisena testipäivänä suunnilleen samaan aikaan. Älä käytä ensimmäistä aamuvirtsaa, sillä virtsan LH-pitoisuus lisääntyy vasta myöhemmin päivällä. Sopivin aika on klo 10.00–20.00 välillä, jolloin LH-hormonin määrä virtsassa on havaittavissa tarkimmin. Vältä juomasta suuria määrää nestettä 2 tuntia ennen testin tekemistä, jotta LH-hormonin pitoisuus ei laimene virtsassa. **Kun olet lukunut ohjeet ja olet valmis tekemään testin, ota testitikku sisäpakkauksesta ja käytä testi mahdollisimman pian. Pidä kiinni vihreästä päästä, ÄLÄ KOSKETA valkoiseen alueeseen, jotta testi ei anna väärää tulosta.**

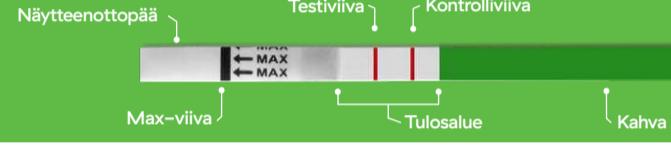


Vaihe 1. Testaus

- Kerää virtsaa puhtaaseen ja kuivaan astiaan. Pari senttimetriä astian pohjalla riittää.
- Pidä kiinni vihreästä päästä, ÄLÄ KOSKETA valkoiseen alueeseen, jotta testi ei anna väärää tulosta.
- Upota näytteenottopäätä virtsaan siten, että nuolet osoittavat alaspin. Älä upota tiukka max-viivaa syvemmälle. Nosta tikku pois 15 sekunnin kuluttua ja laita se tasaiselle, puhtaalle ja kuivalle alustalle.

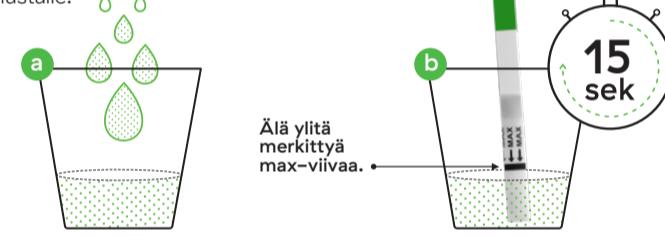

Vaihe 2. Odota 10 min

Odota 10 minuuttia ennen tuloksen lukemista koskematta testiliuskaan. Kun testiliuska alkaa reagoida, koko tulosalute värjätyy vaaleanpunaiseksi. Älä lue testitulosta enää 15 minuutin jälkeen, sillä se saattaa antaa harhaanjohtavan tuloksen.

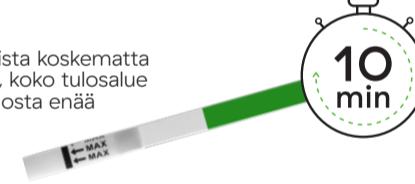

Vaihe 3. Lue testin tulos

Tulosalueen vaalealle taustalle ilmaantuu joko yksi tai kaksi värillistä viivaa. Toinen on kontrolliviiva ja toinen testitulos. **Lue tulos mahdollisimman pian 10 minuutin kuluttua. Älä lue testitulosta enää 15 minuutin jälkeen, sillä se saattaa antaa harhaanjohtavan tuloksen.**



Positiivinen tulos – kohonnut LH-pitoisuus

Jos tulosalueella näkyy kaksi värillistä viivaa ja testiviivan vaaleanpunainen väri on yhtä voimakas tai tummempi kuin kontrolliviiva, LH-pitoisuuden lisääntyminen on havaittu. Munasoluun irtoaminen tulee tapahtumaan 24–36 tunnin sisällä. Hedelmöitymiskyky on paras seuraavien kahden päivän aikana. Raskauden todennäköisyys kasvaa, jos yhdynä tapahtuu näiden 48 tunnin kuluessa. Säästä jäljelle jääneet testilisukat, jos haluat testata uudelleen seuraavassa kierrossa.



Negatiivinen tulos – LH-pitoisuus ei ole kohonnut

Jos vain kontrolliviiva ilmestyy, tai jos testiviiva on kontrolliviivaa vaaleampi, virtsan LH-pitoisuuden nousua ei ole havaittu. Jatka testausta seuraavana päivänä. Jos LH-pitoisuuden nousua ei ole voitu havaittaa tämän kierron aikana, synny voi olla, että:

- LH-huippua ei ehkä ollut tämän kierron aikana. On normaalia, ettei munasolu irtota joka kierrossa.
- Testaus on tehty liian aikaisin tai liian myöhään kierron aikana.
- Virtsan LH-pitoisuus on voinut olla liian alhainen.



Epäonnistunut tulos

Jos punainen/vaaleanpunainen kontrolliviiva ei näy, tai jos yhtään viivaa ei näy testi-ikkunassa, tai jos viivat ovat erivärisiä kuin punainen/vaaleanpunainen/violetti, niin testi ei ole toiminut odotetusti eikä tulos ole pätevä. Tämä saattaa johtua siitä, että näytteenottopäätä ei ole imenyt riittävästi virtsaa, tai testi on tehty virheellisellä tavalla. Tee tällöin uusi testi ja seuraa ohjeita huolella. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä RFSU:hun.



• Naisilla, joilla on munasarjojen monirakkulaireyhtymä (PCOS) voi olla kohonnut LH-pitoisuus.

Säilytys
Säilytä testi ehjässä pakkauksessa jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Testi ei saa säilyttää alle +2°C tai yli +30°C lämpötilassa. Älä jätä pakkausta suoraan auringonvaloon, kosteaan tai kuumaan tilaan. Säilytä lasten ulottumattomissa.

RFSU Ovulaatiotesti on kehitetty yhteistyössä RFSU Klinikin kanssa. Lisätietoja tuotteesta löydät osoitteesta www.rfsu.com.

RFSU on voittoa tavoittelematon aatteellinen järjestö. Toimintamme tuottojen ylijäämä käytetään sektöörivirheitsevys- ja ihmisoikeustyöön Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

Haluatto tietää lisää raskaudesta ja hedelmöitymiskydestä, tai onko sinulla kysymyksiä tuoteistamme? Lue lisää: rfsu.com



Älä käytä testiä, jos foliopakkauksen on vaurioitunut.

IVD Self-test Device

v2019-11-05-08 art nr I3601SF

RFS-231-06

